HCHY117-25-24-H1-CDCL3-20261109-A02.10.fid

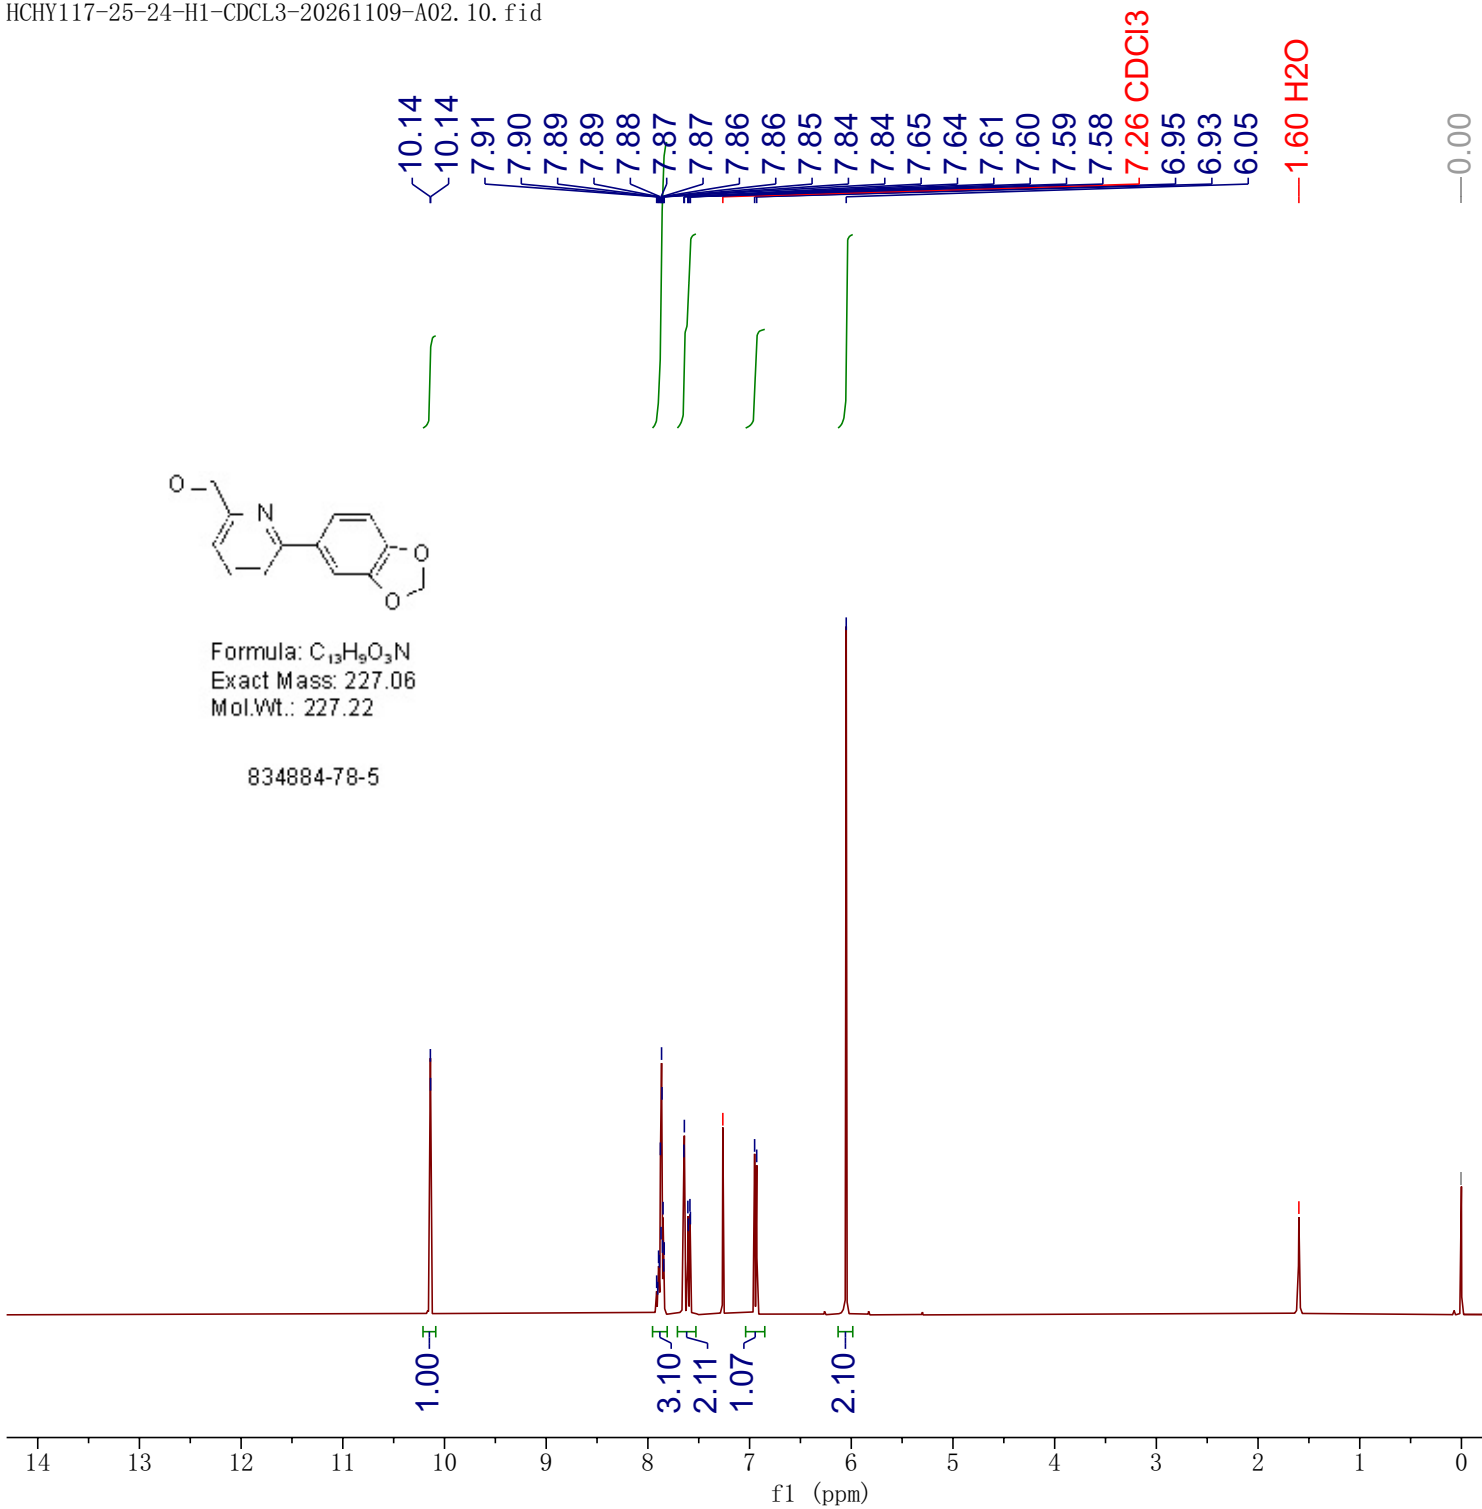


| Parameter | 值 |
|---|---|
| 1 Data File Name | D:/ HCHY117-25-24-H1-CDCL3-20261109-A02/ 10/ fid |
| 2 标题 | HCHY117-25-24-H1-CDCL3-20261109-A02.10.fid |
| 3 Comment | |
| 4 Origin | Bruker BioSpin GmbH |
| 5 Owner | Administrator |
| 6 Site | |
| 7 Instrument | spect |
| 8 Solvent | CDCl3 |
| 9 Temperature | 295.4 |
| 10 Pulse Sequence | zg30 |
| 11 Experiment | 1D |
| 12 Probe | Z108618_0480 (PA BBO 400S1 BBF-H-D-05 Z PLUS) |
| 13 Number of Scans | 8 |
| 14 Receiver Gain | 203.0 |
| 15 Relaxation Delay | 1.0000 |
| 16 Pulse Width | 13.0000 |
| 17 Presaturation Frequency | |
| 18 Acquisition Time | 4.0894 |
| 19 Acquisition Date | 2026-11-09T12:42:21 |
| 20 Modification Date | 2026-11-09T16:09:01 |
| 21 Class | |
| 22 Spectrometer Frequency | 400.25 |
| 23 Spectral Width | 8012.8 |
| 24 Lowest Frequency | -1543.4 |
| 25 Nucleus | 1H |
| 26 Acquired Size | 32768 |
| 27 Spectral Size | 65536 |
| 28 Digital Resolution | 0.12 |